



MICRÓTOMO ROTATIVO DE PARAFINA
SEMI AUTOMÁTICO
MODELO MRP 2016 SA



MANUAL DE PROCEDIMENTO

Lupe Indústria Tecnológica de Equipamentos para Laboratório LTDA

INDÚSTRIA BRASILEIRA – PRODUTO NACIONAL

Site: www.lupetec.com.br

REV. 09

Conteúdo:

1) Descrição do Produto.....	3
2) Especificações Técnicas do Produto.....	4
3) Partes do Produto.....	5
4) Tela de Configurações.....	5
4.1) Escolha de Idioma.....	6
4.2) Ajuda.....	7
4.3) Manutenção.....	7
5) Tela de Operação.....	8
5.1) Ajuste do Trim.....	8
5.2) Ajuste do Corte.....	8
5.3) Retorno da Amostra no Início do Curso.....	9
5.4) Retração da Amostra.....	9
5.5) Salvando Valores de Ajuste de Rotina.....	10
5.6) Carregando os Valores de Preset.....	10
5.7) Reset dos Valores de Preset.....	11
5.8) Verificando o Total de Micras de Desbaste ou Total de Cortes Efetuados.....	11
5.9) Avanço e Retrocesso do Canhão.....	12
6) Instruções de Instalação e Uso do Produto.....	12
6.1) Aplicação.....	13
6.2) Advertências – Segurança.....	13
6.3) Advertências - Transporte e Instalação.....	13
6.4) Requisitos para o Local de Instalação.....	14
6.5) Dispositivos de segurança integrados.....	14
6.5.1) Mecanismo de Trava do Volante de Mão.....	14
6.5.2) Freio do Volante de Mão.....	14
6.6) Porta-navalha para Navalhas Descartáveis.....	15
6.7) Fixações da Amostra.....	15
6.8) Inserções da Navalha ou da Lâmina Descartável.....	15
6.9) Ajuste do Ângulo de Corte.....	16
6.10) Orientação da Amostra.....	16
6.11) Aparagem da Amostra com o Avanço Horizontal.....	17
6.12) Seccionamento.....	17

6.13) Substituição da Amostra	18
6.14) Prendedor de Amostras Padrão (para blocos).....	18
6.15) Prendedor Universal de Cassetes	18
6.16) Base do Porta-navalha	19
6.17) Acessórios	19
7) Limpeza do Aparelho.....	19
8) Cuidados e Advertências.....	21
9) Manutenção e Possíveis Problemas	21
10) Assistência Técnica e Manutenções Preventivas	23
11) Garantia.....	23
12) Simbologia.....	24

Parabéns!

Você acaba de adquirir um Produto com Tecnologia Totalmente Nacional.

Este produto é fruto de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento para que você tenha excelente qualidade no produto adquirido.

Ficamos felizes por você prestigiar a Indústria Nacional que ao longo dos anos vem se dedicando cada vez mais para colocar produtos confiáveis e que atendam as expectativas do Cliente.



Ler este manual antes de realizar qualquer operação do produto.

1) Descrição do Produto

O MICRÓTOMO ROTATIVO DE PARAFINA SEMI AUTOMÁTICO – MODELO MRP 2016 SA foi desenvolvido para uso em Laboratório de Anatomia Patológica, para produzir cortes finos em amostras com diferentes graus de dureza, para aplicações de rotina e pesquisa na biologia.


Acompanha o produto:

- Manual de procedimento;
- Certificado de garantia;
- Gaveta Coletora de Detritos;
- Suporte de Navalhas;
- Morsa Porta Cassetes ou Porta Blocos.

2) Especificações Técnicas do Produto

- **Voltagem:** 100~240 V / 50-60 Hz;
- **Corrente Máxima de Entrada:** 127 V = 241 mA e 220 V = 120 mA;
- **Potência:** 50W;
- **Proteção Contra Penetração Nociva de Água:** IPX0;
- **Faixa de Temperatura:** 10 a 40 ° C;
- **Retração da Amostra:** de 5 a 100 micra;
- **Espessura de corte:**
 - 0 a 2 micra em passos de 0,5;
 - 2 a 10 micra em passos de 1;
 - 10 a 20 micra em passos de 2;
 - 20 a 100 micra em passos de 5;
 - 100 a 600 micra em passos de 50.
- **Espessura de Desbaste:**
 - 0 a 2 micra em passos de 0,5;
 - 02 a 10 micra em passos de 1;
 - 10 a 20 micra em passos de 2;
 - 20 a 100 micra em passos de 5;
 - 100 a 600 micra em passos de 50.
- **Deslocamento das guias horizontais até:** 40 mm;
- **Deslocamento das guias verticais até:** 70 mm;
- **Intervalo de espessura dos cortes:** 0,5 a 600 micra;
- **Coletor de Detritos;**
- **Travamento em 12 horas;**
- **Sistema de Trim Digital;**
- **Navalha descartável: Alto ou Baixo Perfil;**
- **Comprimento do Equipamento:** 560 mm;
- **Largura do Equipamento:** 400 mm;
- **Altura total do Equipamento:** 300 mm;
- **Peso Líquido:** 28,2 kg;
- **Peso Bruto:** 32 kg;
- **Dimensões externas da embalagem:** 650 x 530 x 470 mm;
- **Produto atende a Diretiva 98/37.**

3) Partes do Produto

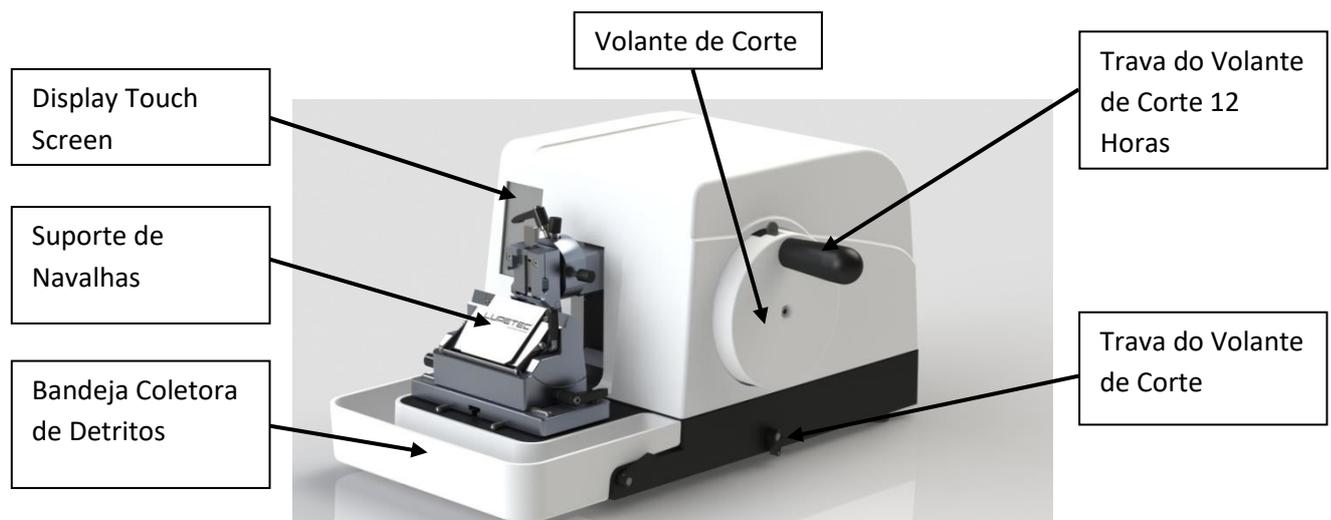

4) Tela de Configurações

Assim que o equipamento for ligado, surgirá a tela abaixo com a versão do software utilizada;



A tela abaixo serve para se efetuar as configurações gerais.



4.1) Escolha de Idioma

Clique em Configurações e Idioma.



Selecione o Idioma, confirme  e retorne .




4.2) Ajuda

Toque no Ícone Ajuda e terá informações sobre procedimentos de problemas de operação do equipamento.



4.3) Manutenção


Item protegido por senha para uso exclusivo de Técnico Autorizado.

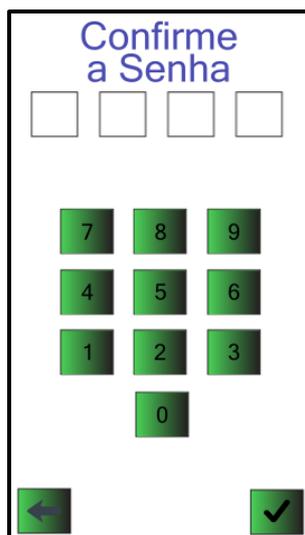

5) Tela de Operação

5.1) Ajuste do Trim

Toque em TRIM e selecione a espessura de Desbaste, através das teclas .

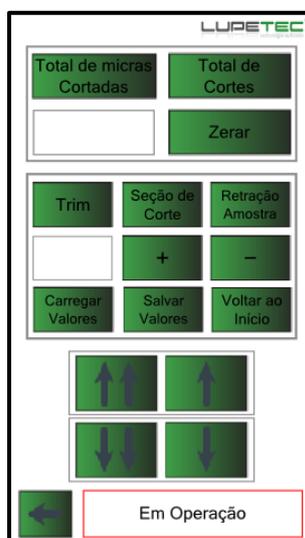


5.2) Ajuste do Corte

Toque em Seção de Corte e, através das teclas , selecione a espessura de Corte.


5.3) Retorno da Amostra no Início do Curso


Toque em  e confirme através da tecla . O canhão retornará automaticamente ao início do ponto de corte.

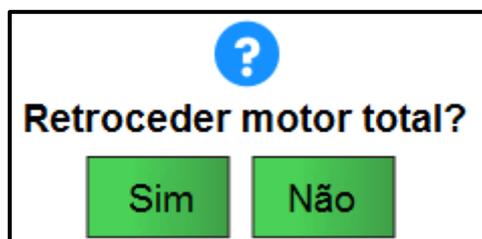

Observação importante: Não realizar operações de corte com o canhão nesta posição inicial (fim de curso anterior). Isto poderá resultar em mal funcionamento do equipamento. O sistema eletromecânico trabalha avançando em função do valor definido na “Seção de Corte”. Porém, ao definir o valor de “Retração da Amostra”, o canhão irá retroceder em função deste valor, para que a fita não seja “rompida” durante a subida do canhão. Este sistema, por sua vez, auxiliará o operador para que fitas contínuas sejam seccionadas. Contudo, se o canhão já estiver no limite anterior – “Voltar ao início” – o sistema não conseguirá realizar a retração da amostra. Isto poderá resultar em cortes “finos” e “grossos”, alternadamente, ou ainda cortes com espessuras diferentes.


5.4) Retração da Amostra

Clique em  para ajustar o valor, em micras, da retração da amostra utilizando as teclas  . Este parâmetro deverá ser ajustado para garantir que a fita não seja rompida pela amostra, durante o movimento vertical da morsa. O valor deste parâmetro poderá ser uma consequência do ângulo da navalha, ou seja, ângulo do suporte.

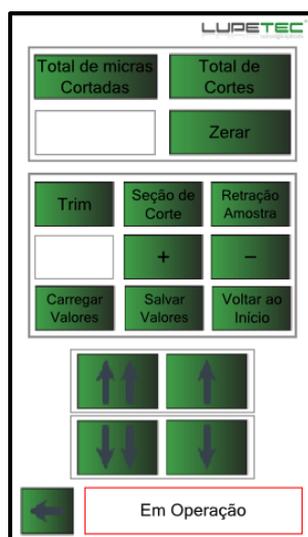


5.5) Salvando Valores de Ajuste de Rotina

Toque em .

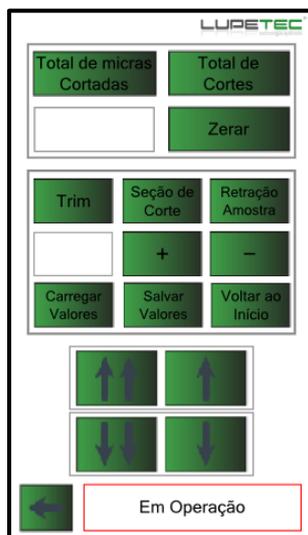


Selecione o PRESET preferido e automaticamente os valores selecionados serão salvos, retornando a Tela Anterior.

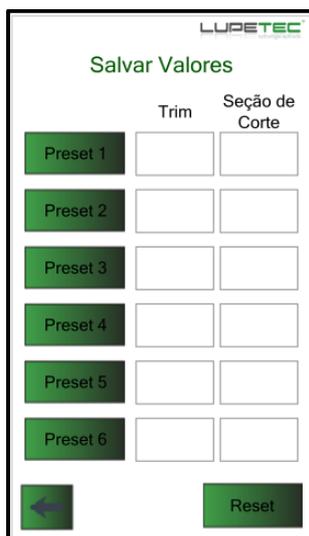


5.6) Carregando os Valores de Preset

Toque em  e selecione o Preset preferido com os ajustes preferidos de TRIM e CORTE e o equipamento estará pronto para uso da forma selecionada.

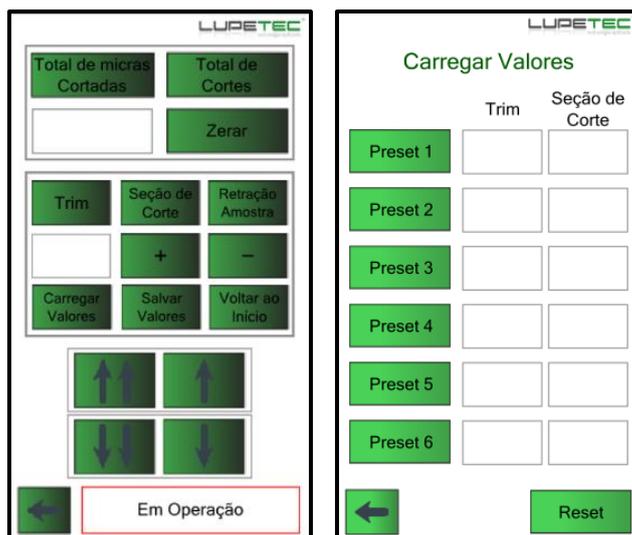

5.7) Reset dos Valores de Preset

Toque em RESET e confirme. Todos os valores de PRESET serão excluídos.
 Caso queira apenas alterar um PRESET, **basta salvar os valores no Preset desejado.**

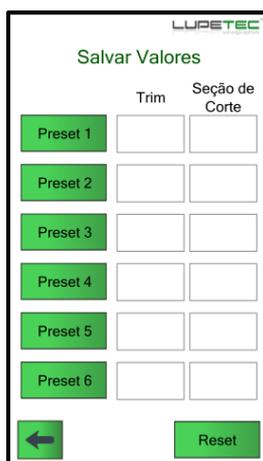


5.8) Verificando o Total de Micras de Desbaste ou Total de Cortes Efetuados

Toque em TOTAL DE MICRAS CORTADAS e terá o número de desbastes efetuados em micras;

Toque em TOTAL DE CORTES e terá o número de cortes efetuados em micras;

Toque em ZERAR para iniciar um novo ciclo de verificação de DESBASTE E CORTE.

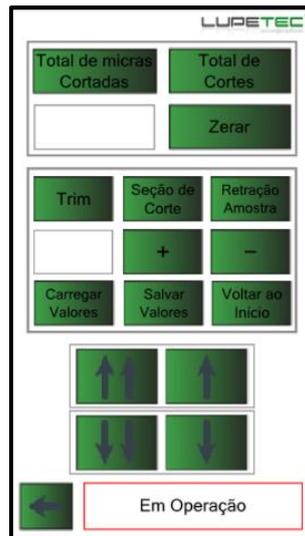

5.9) Avanço e Retrocesso do Canhão

Para avanço rápido do motor toque



Para avanço lento do motor toque



Para recuo rápido do motor toque



Para recuo lento do motor toque



Para retornar a Tela Inicial toque 

6) Instruções de Instalação e Uso do Produto

Leia as instruções para utilizar o equipamento da melhor maneira possível, para uma durabilidade maior do mesmo. Preste muita atenção às precauções que devem ser tomadas durante o manuseio do equipamento.

Leia o Termo de Garantia.

Lupe Indústria Tecnológica de Equipamentos para Laboratório LTDA

INDÚSTRIA BRASILEIRA – PRODUTO NACIONAL

Site: www.lupetec.com.br

Observação: Este produto não requer nenhuma intervenção técnica para sua instalação. Apenas seguir as instruções abaixo:

6.1) Aplicação

O Micrótomo Rotativo de Parafina Semi Automático Lupe modelo MRP 2016 SA é um Micrótomo Rotativo operado manualmente, utilizado para produzir cortes finos em amostras com diferentes graus de dureza, tanto para aplicações de rotina, como de pesquisa na biologia, na medicina e na indústria.

Foram projetados para fazer cortes em materiais moles incluídos em parafina, assim como em amostras mais duras, desde que tais amostras ainda sejam adequadas para seccionamento manual.

Qualquer outro uso do aparelho é considerado indevido.

Uma placa de identificação indicando o número de série do aparelho está afixada a parte lateral do aparelho.

Não se deve remover, nem modificar os dispositivos de proteção, tanto do aparelho como de seus acessórios. Somente os funcionários de serviço técnico autorizado e qualificado poderão fazer reparos e acessar os componentes internos do aparelho.

6.2) Advertências – Segurança

Os dispositivos de segurança instalados neste aparelho constituem apenas uma base para a prevenção de acidentes.

O principal responsável por operações sem acidentes é, acima de tudo, a instituição proprietária do aparelho e, além dela, os funcionários designados para operar, fazer a manutenção, reparos e conserto ou limpeza do aparelho.

Para obter uma operação do aparelho sem problemas, cumpra sempre as instruções e advertências a seguir.

6.3) Advertências - Transporte e Instalação

Após a retirada do engradado, o aparelho somente poderá ser transportado na posição vertical. Ao transportar, nunca segure o aparelho pelos cabos das rodas de mão ou da roda de avanço horizontal, nem pelo botão para ajuste de espessura de cortes.

Não se deve remover, nem modificar os dispositivos de proteção, tanto do aparelho como de seus acessórios.

Tenha extrema cautela ao manusear as navalhas ou lâminas de micrótomos. Os fios das navalhas ou das lâminas são extremamente afiados e podem causar lesões graves!

Antes de tirar o porta-navalha do aparelho, remova sempre a navalha ou a lâmina. As navalhas que não estiverem em uso deverão ser sempre guardadas no estojo de navalhas!

Jamais e em lugar algum deixe uma navalha com o fio virado para cima e nunca tente pegar uma navalha que esteja caindo!

Prenda sempre o bloco da amostra antes de prender a navalha.

Trave a roda de mão e cubra o fio da navalha com o protetor de navalha antes de qualquer manipulação da navalha ou da amostra, antes de substituir o bloco de amostra e durante todos os intervalos de trabalho!

Use sempre óculos de proteção ao fazer cortes de amostras quebradiças! A amostra pode estilhaçar!

Nenhum líquido poderá penetrar no interior do aparelho durante o trabalho!

Somente os funcionários de serviço técnico autorizado e qualificado poderão fazer reparos e acessar os componentes internos do aparelho.

Lupe Indústria Tecnológica de Equipamentos para Laboratório LTDA

INDÚSTRIA BRASILEIRA – PRODUTO NACIONAL

Site: www.lupetec.com.br


Trave a roda de mão antes de iniciar a limpeza do aparelho!
Não use solventes que contenham acetona ou xilol para limpeza!
Nenhum líquido poderá penetrar no interior do aparelho durante a limpeza!
Ao usar produtos de limpeza, obedeça às instruções de segurança do fabricante e os regulamentos de segurança de trabalho de seu laboratório!

6.4) Requisitos para o Local de Instalação

Bancada de laboratório estável, isenta de vibrações com a parte superior horizontal e uniforme; chão praticamente isento de vibrações.
Ausência de aparelhos nas vizinhanças que possam provocar vibrações.
Temperatura ambiente permanentemente entre + 10 °C e 40 °C.
Acesso fácil e desobstruído tanto para a roda de mão quanto para a roda de avanço horizontal.


6.5) Dispositivos de segurança integrados

6.5.1) Mecanismo de Trava do Volante de Mão

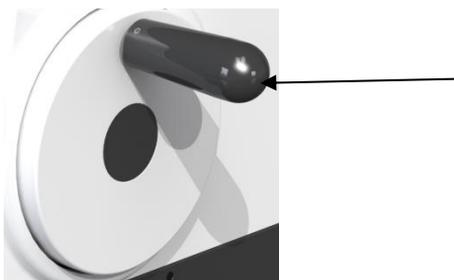

Não substitua as Navalhas de Corte sem Travar o Volante
O volante de mão pode ser travado na posição de 12 horas.
Ao deslocar a alavanca de trava para fora (para a e direita), o volante de mão ficará travado quando atingir a próxima posição de 12 horas.
Para destravar o Volante basta deslocar a alavanca para dentro (esquerda) e ele irá destravar.

6.5.2) Freio do Volante de Mão

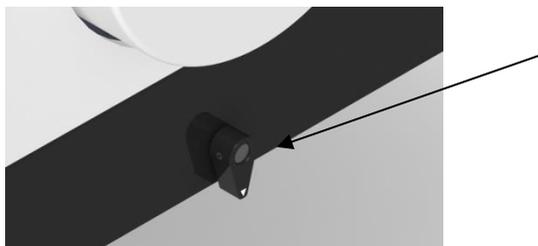

Não substitua as Navalhas de Corte sem Travar o Volante.


É possível ativar o freio do volante de mão, não importando a posição do cabo da trava do volante de mão, utilizando a alavanca localizada no lado esquerdo da placa da base do micrótomo. Quando a alavanca for empurrada para a posição 9 horas, o volante de mão estará destravado.

Para destravar o freio do volante de mão leve a alavanca para a posição 6 horas.

6.6) Porta-navalha para Navalhas Descartáveis

Não substitua as Navalhas de Corte sem Travar o Volante.

O protetor de navalha para navalhas descartáveis pode ser facilmente posicionado por meio das hastes de cobertura do protetor de navalhas. Movimento o protetor para cima e o mesmo irá cobrir o fio da navalha garantindo a proteção da navalha e evitando risco de acidentes.

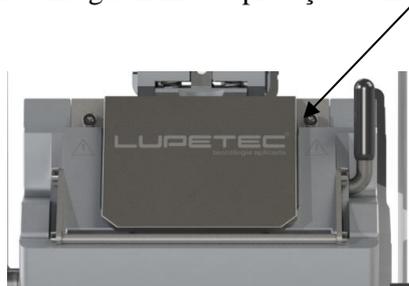

6.7) Fixações da Amostra

Prenda sempre o bloco da amostra ANTES de prender a navalha.

Trave a roda de mão e cubra o fio da navalha com o protetor de navalha antes de qualquer manipulação da navalha ou da amostra, antes de substituir o bloco de amostra e durante todas as interrupções de trabalho!

Gire a roda de mão até que o prendedor de amostras fique na posição mais elevada possível.


Utilize o cabo para travar a roda de mão na posição de 12 horas.

Insira o bloco da amostra no prendedor de amostras.

6.8) Inserções da Navalha ou da Lâmina Descartável

Tenha extrema cautela ao manusear as navalhas ou lâminas de micrótomos. Os fios das navalhas ou das lâminas são extremamente afiados e podem causar lesões graves!

Insira a navalha ou a lâmina descartável com cuidado no porta-navalha e prenda-a através da alavanca lateral.

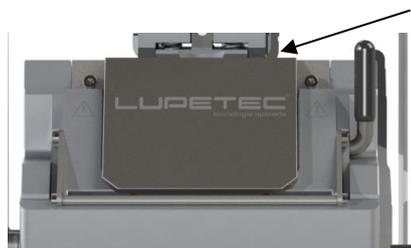

6.9) Ajuste do Ângulo de Corte

Gire a alavanca em sentido anti-horário para liberação.

Mova o porta-navalha até que a marca indicadora do ângulo de afastamento desejado coincida com a linha de referência na base do porta-navalha.

As marcas indicadoras para ajuste do ângulo de afastamento estão localizadas no lado direito do porta-navalha.

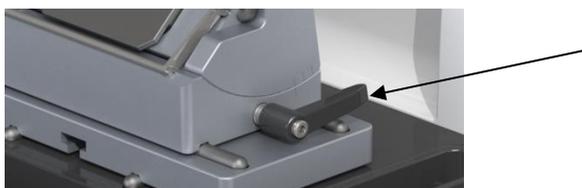


Figura 1

6.10) Orientação da Amostra

Leve o acessório fixo para suporte de amostras até o ponto mais alto (girando a roda de mão) e trave a roda de mão na posição de 12 horas.

Vire a alavanca elíptica (Figura 1) em sentido anti-horário para liberar o mecanismo de sujeição.

Gire o parafuso de ajuste para orientar a amostra no sentido norte-sul (Figura 2). Gire o parafuso de ajuste para orientar a amostra no sentido Leste-Oeste (Figura 2).

Vire a alavanca elíptica em sentido horário para travar o mecanismo de sujeição.

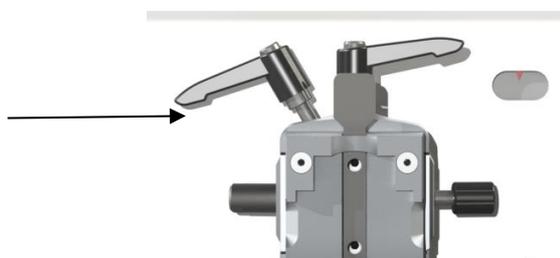


Figura 1

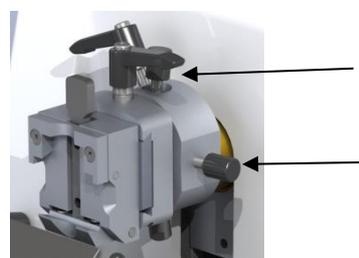


Figura 2

6.11) Aparagem da Amostra com o Avanço Horizontal

Destrave a roda de mão: puxe o cabo (Figura 1) para a direita e libere o mecanismo de freio pela alavanca (Figura 2).



Figura 1



Figura 2

Avance o canhão com amostra através da Tela do Painel Touch Screen (Vide Instruções Touch Screen) para que a amostra se aproxime gradualmente da navalha. Ao mesmo tempo, gire a roda de mão para aparar a amostra até o plano desejado para iniciar o seccionamento.

Selecione uma espessura de corte apropriada para a aparagem através do display Touch Screen.

A espessura selecionada aparece na janela.

Gire a roda de mão até que a amostra tenha sido aparada até o plano desejado.

É possível fazer uma aparagem de desbaste que é selecionada através do Display Touch Screen.

A cada volta da roda de mão a amostra avança de acordo com o selecionado no Display Touch Screen (Trim).

O valor da espessura de corte selecionado não é adicionado ao da aparagem.

Entretanto, se a espessura de corte selecionada for maior que o valor da aparagem, a amostra avançará a distância da espessura do corte sem acrescentar o valor de aparagem.

Gire a roda de avanço horizontal para aproximar a amostra da navalha.

Selecione o valor de aparagem desejado.

Apare a amostra girando a roda de mão (até atingir o plano desejado).

Libere o acionador de aparagem.

6.12) Seccionamento



Gire sempre a roda de mão de maneira uniforme e em velocidade compatível com a dureza da amostra sob seccionamento.

As amostras mais duras devem ser cortadas em velocidades menores.

Lupe Indústria Tecnológica de Equipamentos para Laboratório LTDA

INDÚSTRIA BRASILEIRA – PRODUTO NACIONAL

Site: www.lupetec.com.br

Use o botão de ajuste localizado ao lado direito do painel frontal do micrótomo para selecionar a espessura desejada de corte, a menos que o valor apropriado já esteja sendo exibido na janela. A linha da escala graduada que coincide com a marca de referência vermelha corresponde ao valor selecionado para espessura.

Faça os cortes histológicos usando uma parte diferente do fio da lâmina daquele usado para aparagem.

6.13) Substituição da Amostra

Trave a roda de mão e cubra o fio da navalha com o protetor de navalha antes de qualquer manipulação da navalha ou da amostra, antes de substituir o bloco de amostra e durante todas as interrupções de trabalho!

Conduza a amostra até o ponto mais alto (utilizando a roda de mão) e trave a roda de mão na posição de 12 horas.

Cubra o fio da lâmina com o protetor de navalha.

Retire a amostra do prendedor de amostras e insira o novo bloco de amostra.


Use a roda de avanço horizontal para mover o prendedor de amostras para trás, longe o suficiente para poder iniciar a aparagem de novo bloco de amostra.

Para tal, se você trabalha com um porta-navalha com a opção de ajuste lateral mova a base do porta-navalha ou o porta-navalha até a posição desejada ou se a base de seu porta-navalha não tiver ajuste lateral mova a navalha ou a lâmina propriamente dita.

Inicie o seccionamento girando a roda de mão de maneira uniforme e em sentido horário.

Colete os cortes e monte-os sobre lâminas de microscopia.

6.14) Prendedor de Amostras Padrão (para blocos)



Abra a morsa girando o manipulador no sentido anti-horário;

Coloque o bloco entre os mordentes;

Gire no sentido horário para prender o bloco.

6.15) Prendedor Universal de Cassetes



Lupe Indústria Tecnológica de Equipamentos para Laboratório LTDA

INDÚSTRIA BRASILEIRA – PRODUTO NACIONAL

Site: www.lupetec.com.br

Puxe a alavanca para frente;
Insira o Cassete horizontal ou verticalmente;
Solte a alavanca para prender o cassete no lugar.

6.16) Base do Porta-navalha



- **Base do porta-navalha com deslocamento lateral**

A base do porta-navalha, com recurso para deslocamento lateral, consiste em duas peças e pode ser ajustada tanto na direção norte-sul como na Leste-Oeste.

- **Ajuste Leste-Oeste**

O recurso de deslocamento lateral torna possível a utilização de todo o comprimento do fio da navalha, sem ser necessária nenhuma alteração nos ajustes do porta-navalha.

Para soltar o mecanismo de sujeição vire a alavanca de fixação (localizada no lado esquerdo da base do porta-navalha) para frente.

Ajuste a base do porta-navalha / porta-lâmina lateralmente.

Para reapertar o mecanismo de sujeição, vire a alavanca para trás.

6.17) Acessórios

Portas-navalha para lâminas descartáveis;
Prendedor de amostras padrão;
Prendedor universal de cassetes;
Base do porta-navalha com recurso para deslocamento lateral;
Micrótomo MRP15 básicos;
Acessório fixo para prendedores de amostras orientável;
Cassete padrão.

7) Limpeza do Aparelho

Antes de tirar o porta-navalha do aparelho, remova sempre a navalha ou a lâmina. As navalhas que não estiverem em uso deverão ser sempre guardadas no estojo de navalhas!

Jamais e em lugar algum deixe uma navalha com o fio virado para cima e nunca tente pegar uma navalha que esteja caindo!

Ao utilizar produtos de limpeza, obedeça às instruções de segurança do fabricante e os regulamentos de segurança de trabalho de seu laboratório!

Lupe Indústria Tecnológica de Equipamentos para Laboratório LTDA

INDÚSTRIA BRASILEIRA – PRODUTO NACIONAL

Site: www.lupetec.com.br

Não limpe as superfícies externas com álcool ou com produtos de limpeza à base de álcool (limpos-vidros!), nem com produtos abrasivos ou com solventes que contenham acetona ou xilol!
As superfícies esmaltadas não são resistentes a acetona ou a xilol!
Nenhum líquido poderá penetrar no interior do aparelho durante a limpeza!

Antes de cada limpeza, execute as seguintes etapas preparatórias:

- Mova o prendedor de amostras até a posição limite superior e trave a roda de mão.
- Retire a lâmina ou a navalha do porta-navalha e insira no recipiente para lâminas usadas na base do dispensador de lâminas ou guarde no estojo de navalhas.
- Retire o porta-navalha e a base do porta-navalha para limpeza.
- Retire a amostra do prendedor de amostras.
- Retire os resíduos de cortes com um pincel seco.
- Retire o prendedor de amostras e limpe em separado o aparelho e as superfícies externas.
- Se necessário, as superfícies esmaltadas externas podem ser limpas com um produto suave para limpeza doméstica ou com água e sabão; em seguida, deverão ser secas com um pano.
- Dobre o protetor de navalhas para baixo.
- Vire a alavanca de fixação para baixo.
- Remova cuidadosamente a lâmina.
- Puxe a alavanca de fixação lateralmente.
- Limpe com um pano úmido (mas não molhado!). Para limpar, use apenas produtos suaves de limpeza doméstica ou água e sabão!
- Seque o porta-navalha e faça a remontagem.
- Ao fazer a remontagem, confira se a borda superior da placa de pressão está paralela a borda superior da placa de pressão traseira e na mesma altura desta borda.
- Se necessário, ajuste a placa de pressão (capítulo 5.8.9).
- Destaque o prendedor de cassetes para uma limpeza profunda, removendo todos os resíduos de parafina.
- Mantenha o prendedor de cassetes em forno quente sob temperatura máxima de 65 °C até que toda a parafina tenha se liquefeito e drenado para fora do prendedor.
- Remova os resíduos de parafina com um pano seco.
- Após este procedimento de limpeza em forno, proceda sempre a lubrificação do eixo da alavanca de fixação.

8) Cuidados e Advertências

Leia as instruções de manuseio do produto cuidadosamente e informe-se sobre os detalhes técnicos antes do uso.

- Para qualquer reparo ou manutenção, deverá ser acionada a Rede Autorizada;
- Verifique sempre a rede elétrica em que seus equipamentos irão funcionar. A rede elétrica deverá ser correspondente a fornecida pelo serviço de energia e deverá ser estável;
- A LUPETEC sugere a utilização de estabilizador e/ou nobreak a fim de que qualquer instabilidade na rede elétrica, proveniente de um fornecimento de rede não confiável, seja minimizada. A utilização destes equipamentos irá garantir o bom funcionamento dos equipamentos Lupetec e poderão aumentar sua vida útil, bem como garantirão a eficiência do processamento de dados eletrônicos, responsáveis pela correta automação do produto;
- **Solventes como Xilol e seus derivados não devem ser utilizados para limpeza do produto. Isso poderá causar danos irreparáveis ao Produto;**
- **Risco de incêndio: combustíveis ou substâncias inflamáveis não devem ser manuseados próximos ao equipamento;**
- **É indispensável o acompanhamento de um técnico de laboratório e/ou responsável habilitado durante todo o ciclo de funcionamento do equipamento;**
- **A Lupetec não se responsabiliza por danos causados aos equipamentos que estiverem em funcionamento sem acompanhamento de pessoa tecnicamente habilitada para seu uso;**
- **A velocidade de giro do volante responsável por cortar e desbastar deve ser de, no máximo, 60 rotações por minuto (60 rpm).**

9) Manutenção e Possíveis Problemas

- Para qualquer reparo ou manutenção, o equipamento deve ser desligado e desconectado da tomada.
- Veja abaixo alguns problemas que podem ocorrer e suas causas e soluções.
- Se acaso o problema não se enquadrar nestes descritos, favor entrar em contato imediatamente com o nosso setor técnico – ver detalhes no final do manual.

Problema	Causa	Solução
<p>Cortes Espessos ou Finos</p> <p>As seções alternam entre grossas e finas ou há vibração nas seções ou a amostra é arrancada do encaixe ou não há cortes de modo algum.</p>	<p>A Navalha, suporte da navalha ou orientação não está presa de modo adequado.</p> <p>A amostra não está presa de modo adequado.</p> <p>A navalha está sem corte.</p> <p>O ângulo de incidência da navalha precisa ser corrigido.</p>	<p>Prenda a navalha novamente ou o porta-navalhas.</p> <p>Verifique se o cassete está preso de modo seguro no prendedor universal de cassetes.</p> <p>Se o prendedor universal de cassetes estiver sujo de parafina, limpe com querosene.</p> <p>Ao usar cassetes cuja tampa é moldada, certifique-se de que a borda quebrada permita que o cassete seja fixado de forma segura.</p> <p>Se necessário, prenda o cassete no prendedor universal de cassetes horizontalmente em vez de verticalmente.</p> <p>Se mesmo assim o cassete não ficar preso entre em contato com nossa Assistência Técnica.</p> <p>Desloque o porta-navalha lateralmente ou coloque uma lâmina nova.</p> <p>Experimente no Porta Navalhas ângulos de incidência maiores, até que encontre o ângulo ideal.</p>
<p>Cortes Comprimidos.</p> <p>Os cortes ficam muito comprimidos, apresentam dobras ou são pressionados.</p>	<p>A Navalha perdeu o corte.</p> <p>A amostra precisa ser resfriada.</p> <p>A velocidade de corte é muito alta.</p>	<p>Use outra parte da navalha ou uma navalha nova.</p> <p>Resfrie a amostra antes de cortar.</p> <p>Reduza a velocidade de corte.</p>
<p>Ruídos durante o corte.</p> <p>A faca "canta" ao cortar amostras duras. Os cortes mostram marcas de vibração.</p>	<p>A velocidade de corte é muito alta.</p> <p>O ângulo de incidência é muito grande.</p> <p>Fixação do prendedor da amostra ou do porta-navalha não é suficiente.</p>	<p>Gire o volante em velocidade mais lenta.</p> <p>Reduza o ângulo de incidência da navalha até encontrar um ângulo ideal.</p> <p>Verifique todas as conexões de parafuso e de prendedores no sistema de suporte de amostra. Se necessário, aperte alavancas e parafusos.</p>

Problema	Causa	Solução
Não há movimento de avanço e não há corte.	O canhão avançou até a posição extrema	Leve a amostra para trás, girando o volante de avanço no sentido anti-horário.
Alto Consumo de navalha.	Força de corte aplicada muito grande.	Ajuste a velocidade de corte. Mude a espessura de corte. Gire o volante mais lentamente.

10) Assistência Técnica e Manutenções Preventivas

Manutenção preventiva indicada a cada 2.500 horas de uso:


Esse equipamento foi desenvolvido para operar até 2.500 horas sem necessidade de manutenção preventiva, baseado na utilização média de até 10 horas diárias, durante 1 ano. Caso haja necessidade de utilizá-lo por mais tempo, é indicada a realização de manutenções preventivas em prazo menor ao de 12 meses. Conforme tabela indicativa abaixo:

Entre 8 e 10 horas de uso durante dias úteis: manutenções preventivas a cada 12 meses.
Entre 12 e 20 horas de uso durante dias úteis: manutenções preventivas a cada 6 meses.
Uso superior a 20 horas durante dias úteis: manutenções preventivas a cada 4 meses.

11) Garantia


Os termos da garantia encontram-se anexo a este manual.

12) Simbologia



THIS WAY UP

POSIÇÃO CORRETA PARA TRANSPORTE



KEEP AWAY FROM SUNLIGHT

MANTENHA LONGE DA LUZ SOLAR




FRAGILE

FRÁGIL




KEEP AWAY FROM RAIN

MANTENHA LONGE DA CHUVA



TEMPERATURE LIMITS

TEMPERATURA TOLERÁVEL



STACKING LIMIT BY NUMBER

EMPILHAMENTO MÁXIMO



*MICRÓTOMO ROTATIVO DE PARAFINA
SEMI AUTOMÁTICO MRP2016SA*

Nº série: XXXXXX

Data de fabricação: XXXXXX

Validade: Indeterminada

Av. Romualdo Villani, 728 - Jd. Ipanema

São Carlos SP - Fone: (16) 33611125



Data de Fabricação:

Tensão: 100~240 V

Número de Série:

Potência: 50 W

Frequência: 50/60Hz

Operação: Contínua

EQUIPAMENTO CLASSE I

IPX0

Resp. Téc.: Luiz Ricardo Martins

CREA-SP: 5060262236

Lupe Indústria Tecnológica de Equipamentos para Laboratório LTDA

INDÚSTRIA BRASILEIRA – PRODUTO NACIONAL

Site: www.lupetec.com.br



LUPE INDÚSTRIA TECNOLÓGICA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

Site: www.lupetec.com.br

Avenida Romualdo Villani, 728 – Bairro Jardim Ipanema

São Carlos – São Paulo - Brasil

CEP: 13563-651

Fábrica: +55-16-3361-1125 / 3372-0357

Departamento comercial: +55-16-3416-4859

Departamento de licitações: +55-16-3416-4857

Assistência Técnica em Garantia e suporte telefônico: +55-16-3361-1125 / +55-16-3372-0357

*Assistência Técnica Autorizada para equipamentos fora da Garantia, Biomicro Técnica:
+ 55-11-2651-2261 / +55-11-2082-3178*

*Para maiores informações e esclarecimentos favor entrar em contato com nosso
departamento Técnico +55-16-3361-1125 / +55-16-3372-0357*

Responsável Técnico: Luiz Ricardo Martins – CREA SP 5060262236

Registro Anvisa: 81585500001

Produto não perecível.

Vida útil estimada de 5 anos.

*REPRESENTANTE EUROPEU: CINTERQUAL – Soluções de Comercio Internacional,
LTDA.*

Rua Fran Pacheco, N° 220- 2° Andar.

2900-374 – Setúbal – Portugal

Tel.: +351 265238237

E-mail: cinterqual.Portugal@sapo.pt

Site: www.cinterqual.org e www.cinterqual.com

*Lupe Indústria Tecnológica de Equipamentos para Laboratório LTDA
INDÚSTRIA BRASILEIRA – PRODUTO NACIONAL*

Site: www.lupetec.com.br